ООО «Импульс»

Инструкция по установке программного обеспечения «Анализатор»

2024 г.

Аннотация

Настоящий документ представляет собой инструкцию по установке экземпляра программного обеспечения «Анализатор» (далее – ПО или программа), предоставленного для проведения экспертной проверки. Документ содержит описание действий по установке и настройке ПО.

Содержание

1. Общие сведения..... 4

1.1 Наименование программного обеспечения..... 4

2. Комплекс технических средств 4

3. Порядок установки программного обеспечения..... 5

1. Общие сведения

1.1 Наименование программного обеспечения - Программное обеспечение **«Анализатор»** - выполняющая функции приема и обработки данных от копра маятникового, предназначена для анализа механических свойств материалов при их испытании на ударную вязкость в соответствии со стандартами ГОСТ 9454, ГОСТ 4647, ГОСТ 4647 п.4 (ГОСТ Р ИСО 148, ГОСТ 6996, ASTM E23, ASTM A370).

2. Комплекс технических средств

Для работы с ПО рабочие станции пользователей должны удовлетворять требованиям к техническому обеспечению,

1. Операционная система: не ниже Windows 10 64bit;
2. ПК и процессор: процессор с частотой не менее 1300 МГц;
3. Память: не менее 2 ГБ оперативной памяти;
4. Жесткий диск: не менее 2 ГБ свободного дискового пространства;
5. Монитор: Монитор с разрешением не менее 1024 x 768.


3. Порядок установки программного обеспечения

3.1 Перейти по предоставленной ссылке на экземпляр программного обеспечения **«Анализатор»** для дальнейшего проведения экспертной проверки:


https://tpmarket.ru/kopry-mayatnikovye/programmnoe-obespechenie-priema-i-obrabotki-dannyh-mayatnikovyh-koprov-174

3.1. На открытой странице нажать на активную ссылку загрузки ПО **«Анализатор»**


Установочный файл ПО Анализатор (ознакомительная версия) https://tpmarket.ru/files/Koper_Setup_1_0_0_11.rar ,

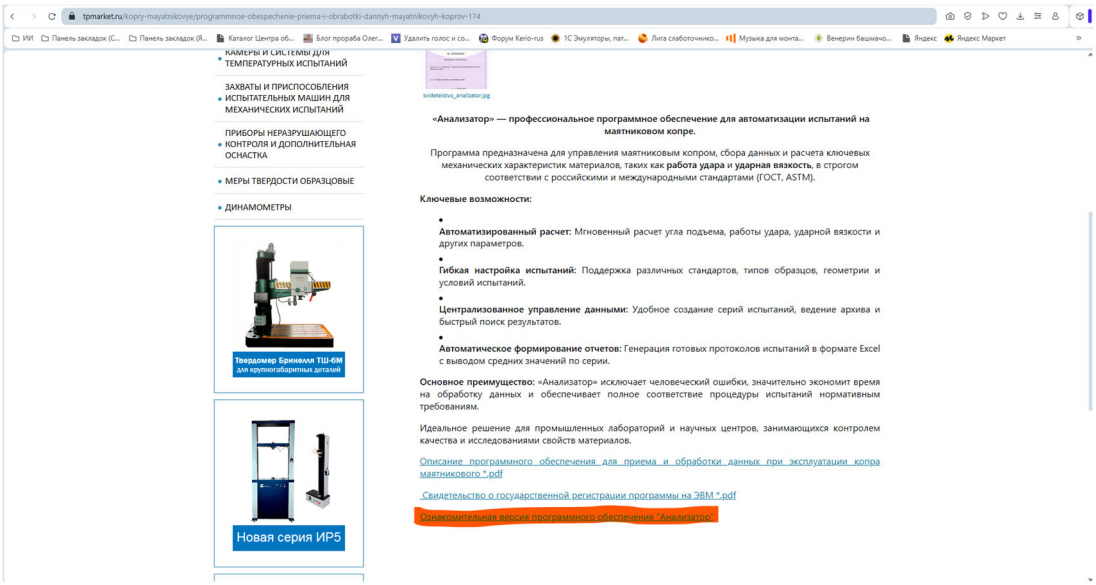

после чего запустится загрузка файла архива с программным обеспечением **«Анализатор»**.

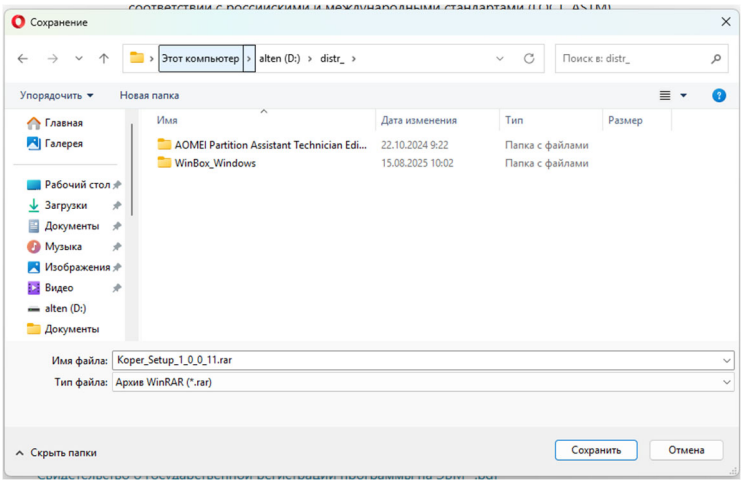


После загрузки архива, разархивируйте установочный файл Koper_Setup_1_0_0_11.exe (пароль на архив 4321)

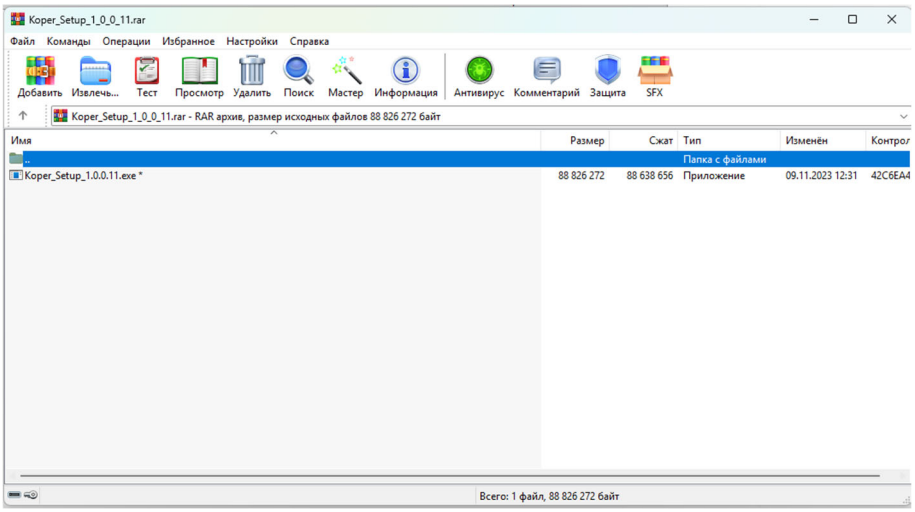



3.2 Запустить файл дистрибутива ПО **«Анализатор»**. Koper_Setup_1_0_0_11.exe

3.3 Запустить загрузку мастера по установке ПО

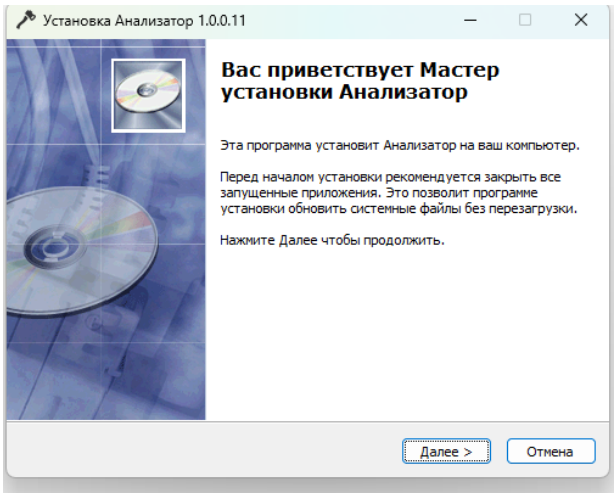


При необходимости выбрать компоненты и выбрать папку в меню для размещения ярлыка программы, по умолчанию будет указано имя программного обеспечения нажав на пункт «Опции».

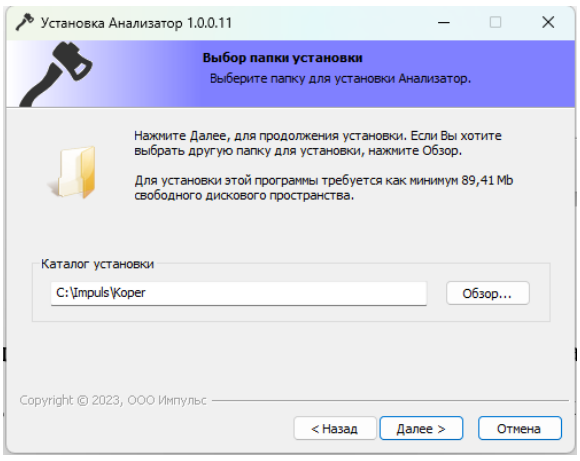

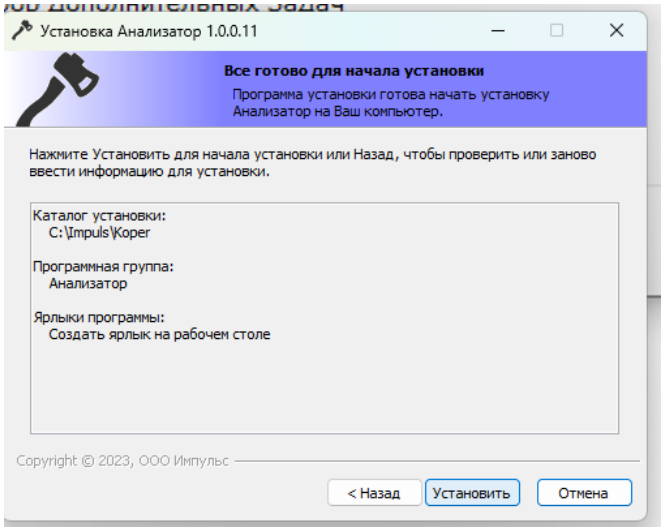


3.4 Для продолжения процесса установки нажать кнопку «Установить»

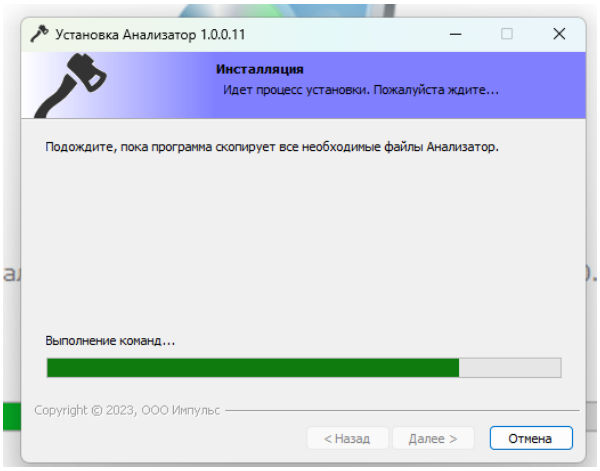


Запустится процесс установки программного обеспечения

3.5 По завершению установки ПО появится уведомление об успешной установке ПО **«Анализатор»** с предложением о запуске программы

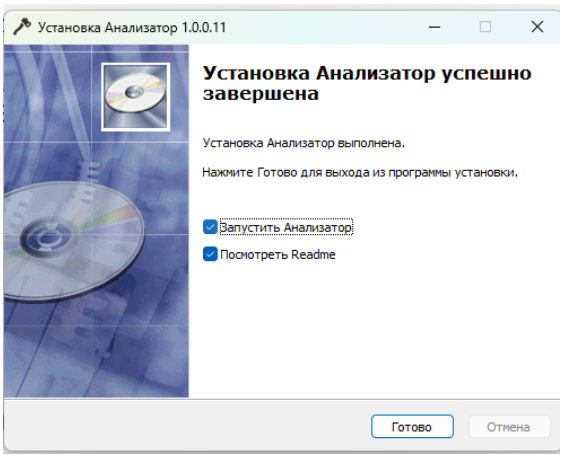

При успешной установке на рабочем столе будет создан ярлык программного обеспечения **«Анализатор»**.

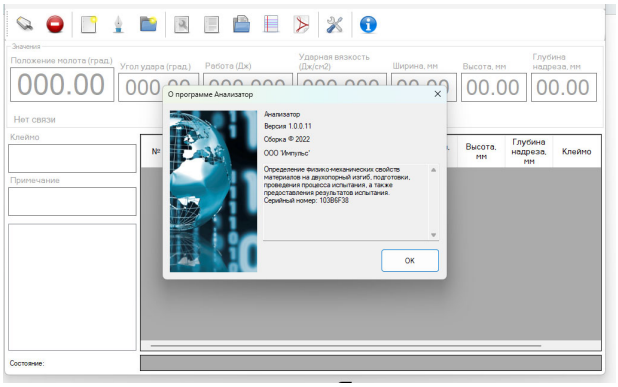
Значения
Положение молота (град.)
000.00
Угол удара (град.)
Работа (Дж)
Ударная вязкость (Дж/см2)
Ширина, мм
Высота, мм
00.00
Глубина надреза, мм
00.00
Нет связи
Клейно
Примечание
Состояние:
№
Высота, мм
Глубина надреза, мм
Клейно
О программе Анализатор
Анализатор
Версия 1.0.0.11
Сборка ® 2022
ООО 'Импульс'
Определение физико-механических свойств материалов на двухопорный изгиб, подготовки, проведения процесса испытания, а также предоставления результатов испытания.
Серийный номер: 103B6F38
OK